


# FOTO postup při výměně pouzdra displeje

## Brilix - náhradní displej dotykový - Hidrolife / Oxilife - 1BP02-04-002

1) Dva druhy displeje

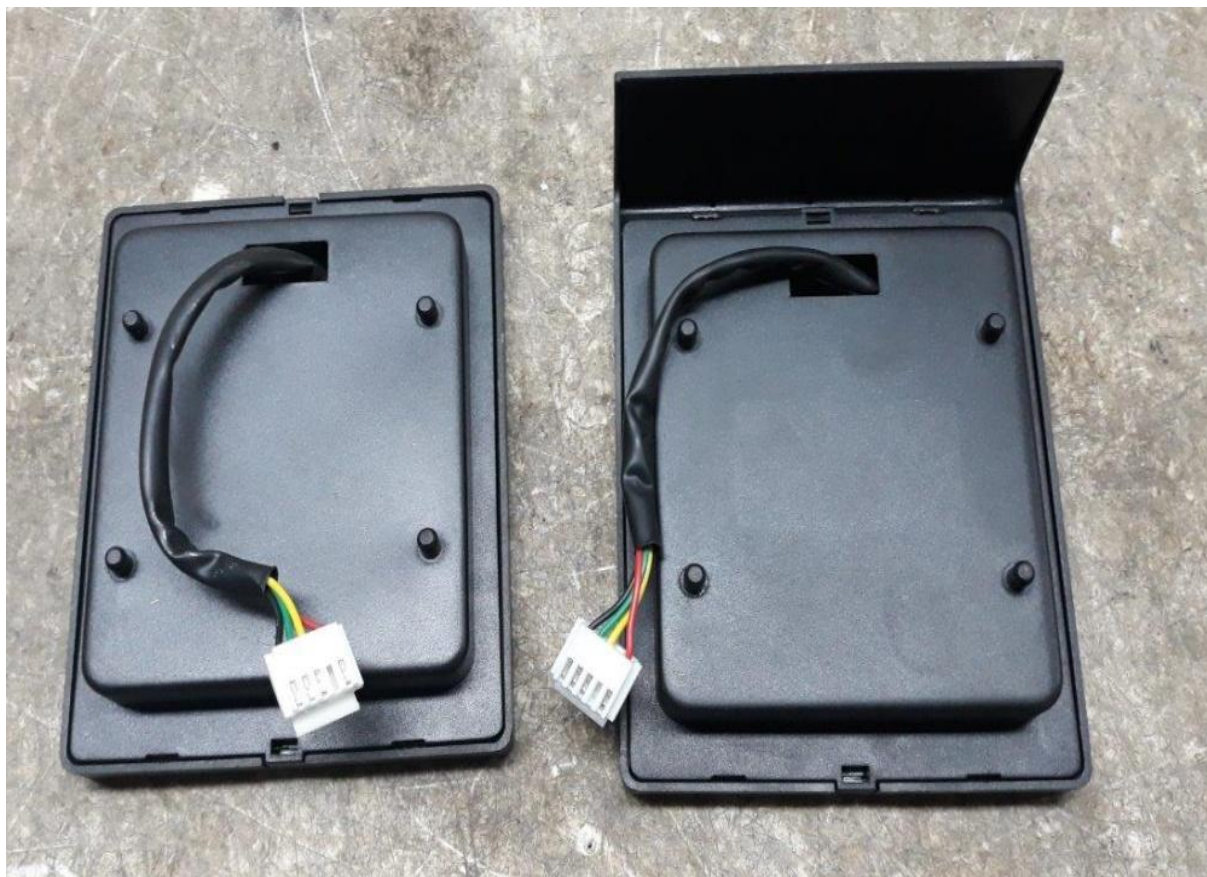

2) Zadní kryt se vysadí pomocí šroubováku.





3) Displej pomocí šroubováku vyjmeme z obalu a prohodíme je do správného krytu.



4) Kryty vrátíme zpět.

